

## Perturbing effects of the probe support on the calibration of electric field meters

O. Bottauscio<sup>1</sup>, M. Chiampì<sup>2</sup>, G. Crotti<sup>1</sup>, and L. Zilberti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), Strada delle Cacce 91, 10135 Torino, Italy


<sup>2</sup> Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino, Italy

Received: 21 January 2010

Published online: 16 February 2010 – © EDP Sciences

Eur. Phys. J. Appl. Phys. 42, 345–350 (2008), DOI: 10.1051/epjap:2008065

An error occurred in Figure 2, page 347 of the original article.  
The correct Figure 2 is as below. We apologise for this error.

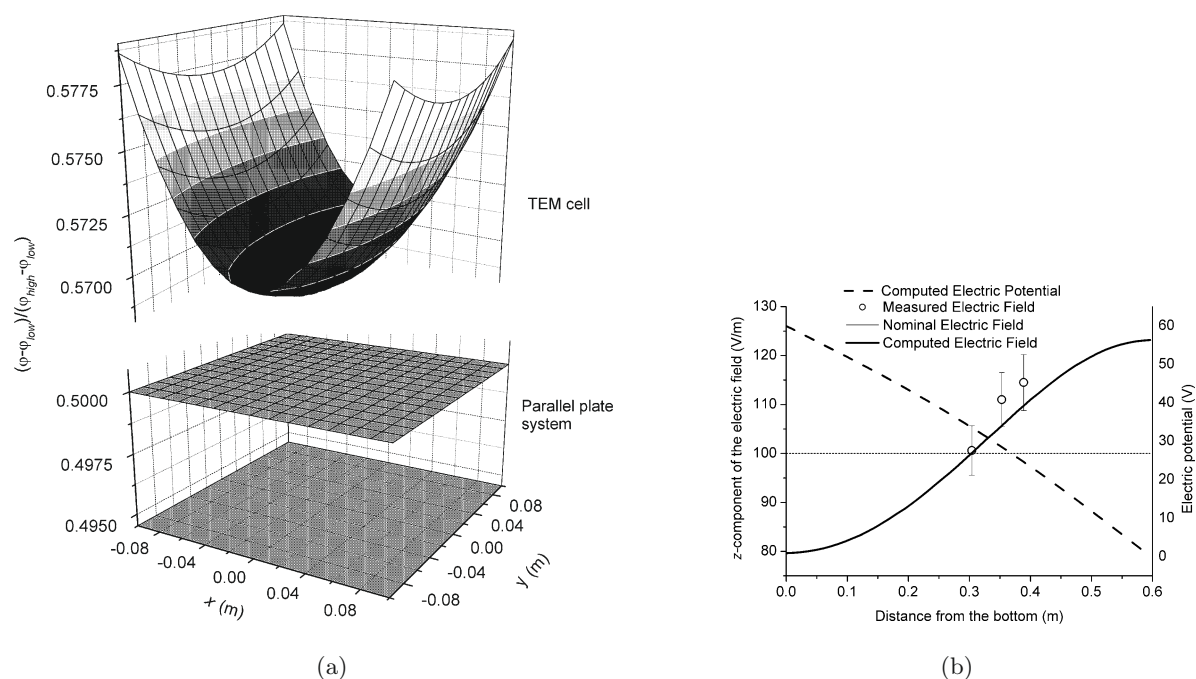

**Fig. 2.** Normalized electric potential distribution over a square surface around the system center in the parallel plates and in the TEM cell (a). Potential and electric field distribution along a line between the electrodes in the center of the TEM cell (b). The nominal electric field value is 100 V/m; the dots are the measured field values.